

Tubo de Raio-X de Ânodo Fixo

- ❖ Especialmente projetado para a unidade de Raio-X dentária intraoral.
- ❖ Este tubo tem 0.8 mm e permite uma tensão máxima do tubo de 70kV.
- ❖ Instalado no mesmo recinto com o transformador de alta tensão.
- ❖ Os produtos Kailong aderem aos padrões de qualidade IEC.
- ❖ Certificação, por exemplo CE, CFDA, ANVISA.



Dados gerais

Classificação de segurança:

FDA	I
IEC60601-1: 2005	IB
Diretiva 93/42 / CEE	IIB

Aplicação unidade de Raio-X dentária intraoral

Características Elétricas:

O circuito:

Gerador de alta tensão	Circuito independente
Aterramento	Polo aterrado
Tensão nominal do tubo de Raio-X (IEC60613: 2010)	70 kV
Valor nominal do Ponto focal (IEC60336: 2005)	0.8
Potência de entrada do ânodo nominal (em 1s)	
Ciclo de trabalho de exposição de 840 W	1:30 ou mais (tempo de exposição: intervalo)

Características Mecânicas:

Dimensões

Comprimento total	Ver o desenho dimensional (pág.6)
Diâmetro máximo	Ver o desenho dimensional (pág.6)
Alvo:	
Ângulo	19 graus
Material	Tungstênio
Filtração Inerente	mín. 0,8 mm Al / 50 kV
Cobertura radiológica	φ70 mm em SID 200 mm

Método de refrigeração Arrefecimento do óleo imerso (60 ° C máx.) e por convecção

Fixação do tubo Segurando o envelope de vidro da extremidade do ânodo e extremidade do cátodo ou o parafuso da haste do ânodo.

Classificação máximas e mínimas absolutas

(Estes valores não devem ser excedidos)

Tensão máxima do tubo de Raio-X (IEC60613: 2010)70 kV

Entre o ânodo (ou cátodo) e terra35 kV

Tensão mínima do tubo de Raio-X.....50 kV

Corrente máxima do tubo de raios X (IEC60613: 2010) 12 mA

Corrente máxima no filamento2.2

Tensão do filamento (na corrente máxima do filamento 2,2 A)2.5 ~ 3.6V

Características térmicas:

Conteúdo de calor no ânodo7000J

Dissipação máxima de calor do ânodo 140W

Tempo máximo de exposição radiográfica 3,2 s

Limites ambientais

Limites de operação:

Temperatura óleo10 ~ 60 ° C

Pressão do óleo70 ~ 106 kPa

Limites de Armazenamento para Transporte:


Temperatura-40 ~ 70 ° C

Umidade10 ~ 90%

(N condensação)

Pressão atmosférica50 ~ 106 kPa

Características Térmicas do Ânodo

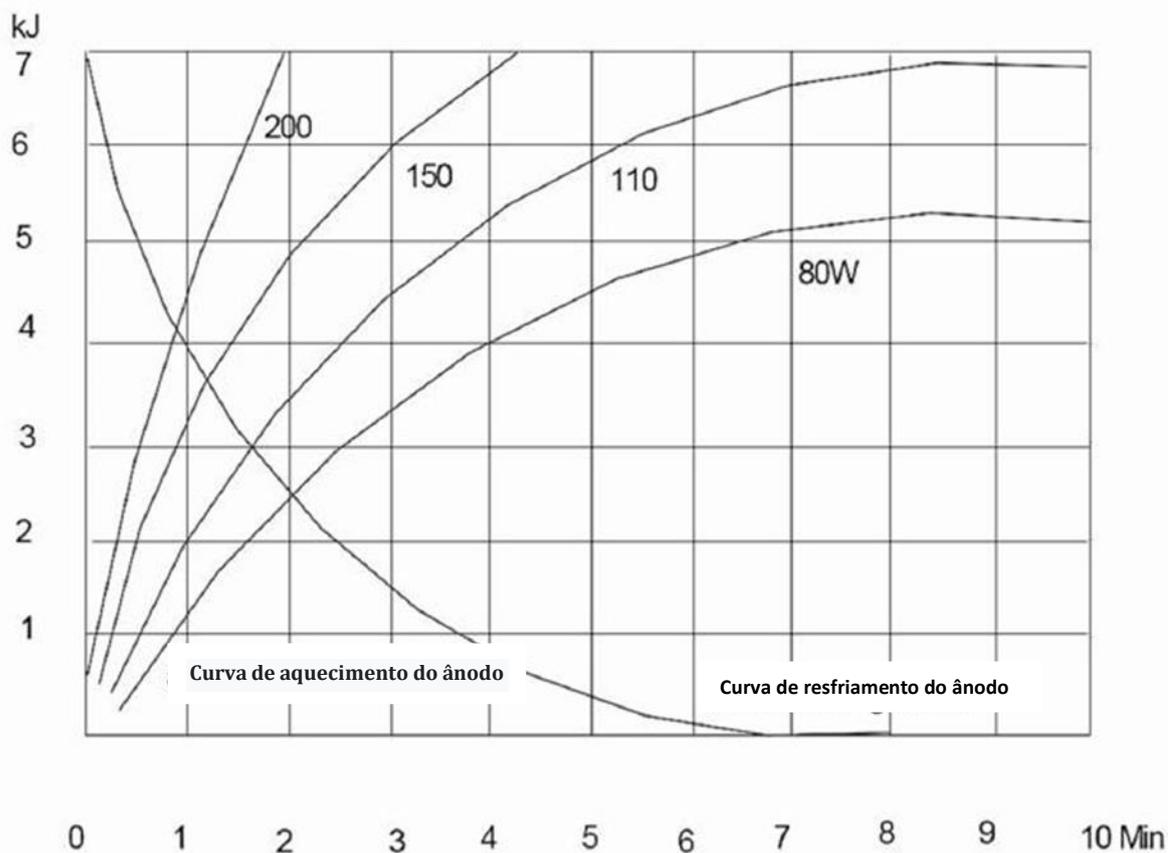

Gráficos de classificações máximas absolutas

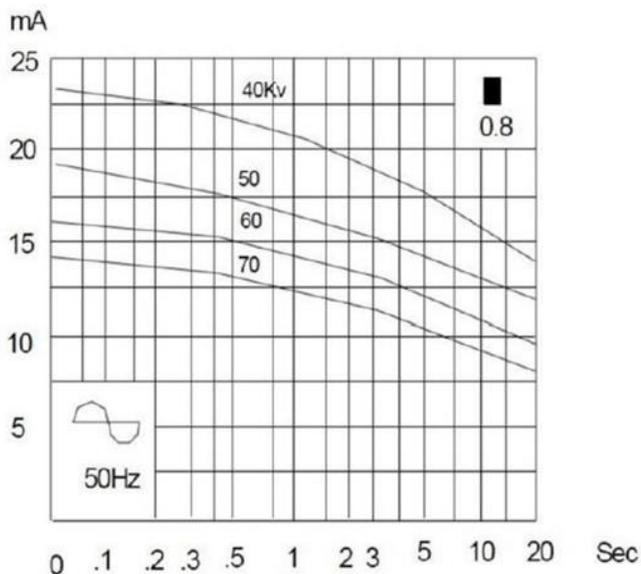


Gráfico de classificação



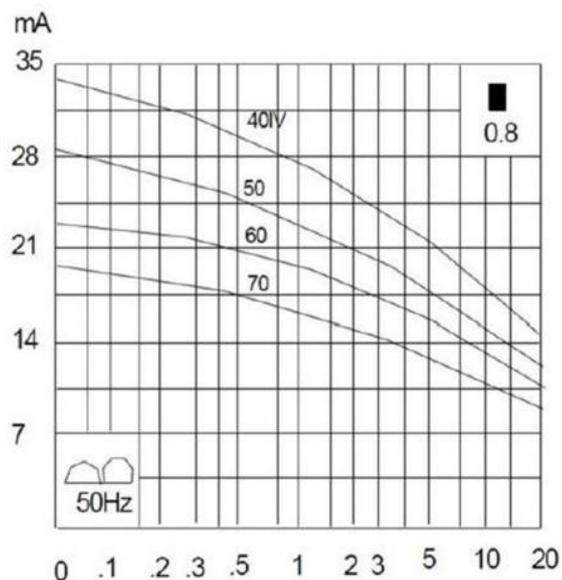


Gráfico de classificação

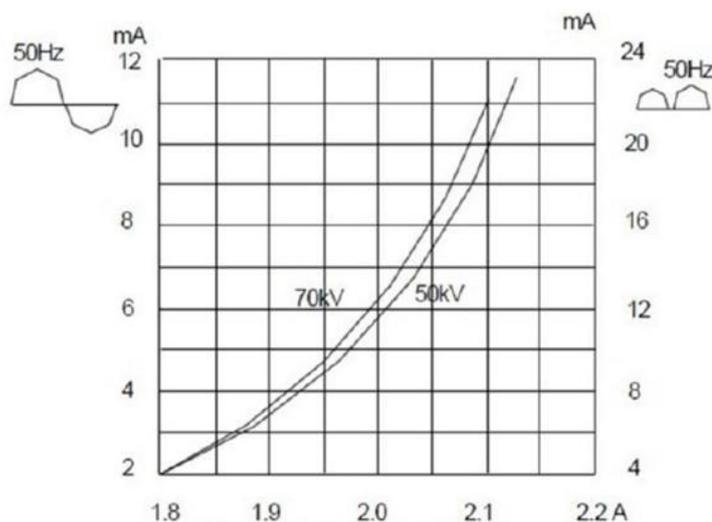


Características de emissão do cátodo

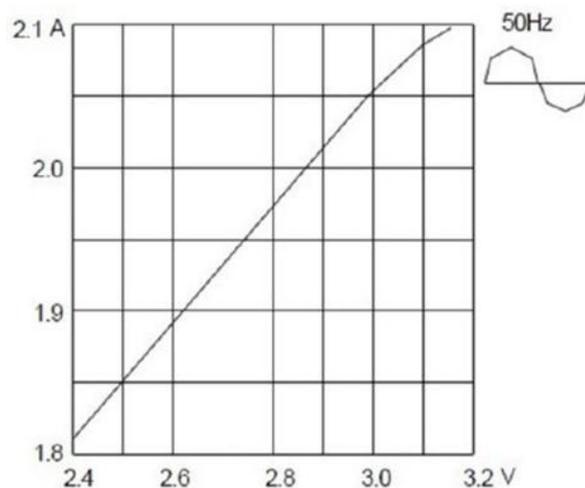

Características do Filamento

Desenho do Tubo de Raio-X tridimensional - KL27-0.8-70

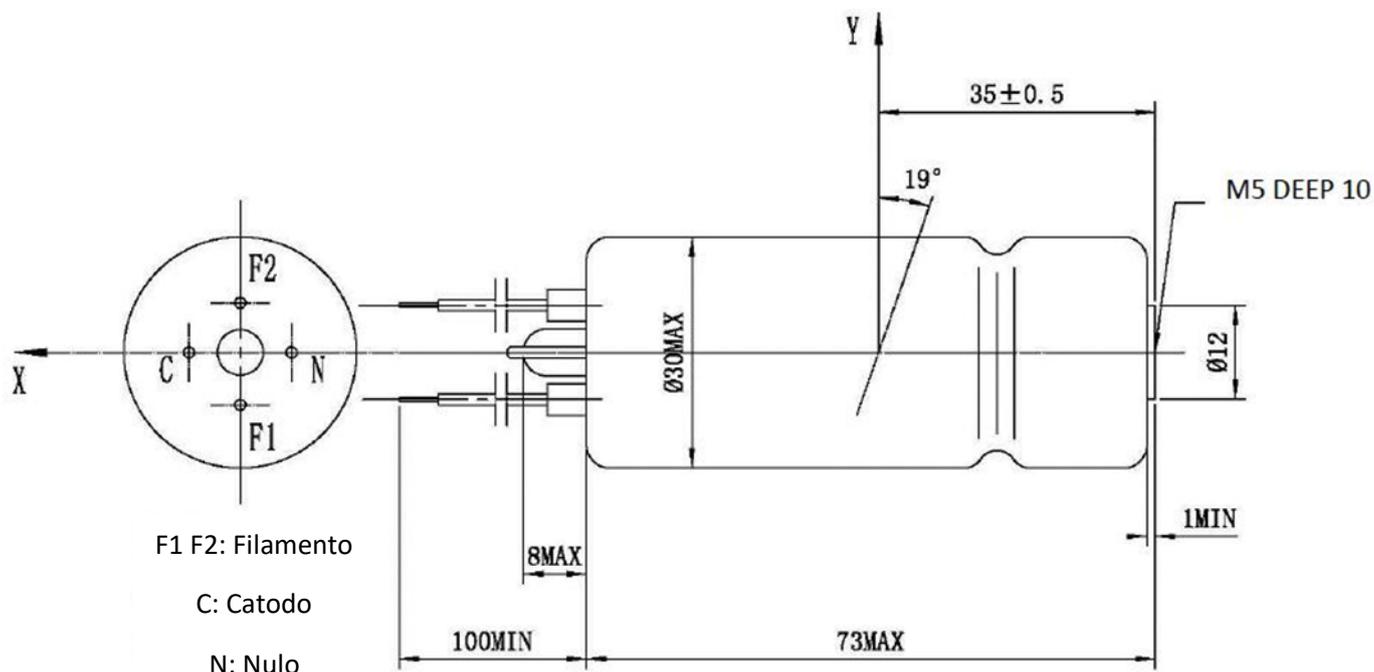

Eixo X: Horizontal Eixo Y: Vertical

Desenho de contorno

(KL27-0.8-70)

Cuidados !!!

O tubo de raios-X irá emitir Raio-X quando ele for energizado com alta tensão, ao manuseá-lo, conhecimento técnico especial deve ser exigido e precauções devem ser tomadas.

1. Apenas um especialista qualificado com conhecimento em tubo de Raios-X e unidades seladas deve montar e remover o tubo. Ao montar os inserts (Ampola) no Housing deve-se adotar precauções apropriadas, a fim de evitar a quebra ampola de vidro. É necessário utilizar também luvas de proteção e óculos.
2. O tubo conectado a alta tensão é uma fonte de radiação: certifique-se de tomar todas as precauções de segurança necessárias para manuseá-lo.
3. Lavar cuidadosamente com álcool a superfície externa da inserção do tubo (cuidado, perigo de incêndio). Evitar o contacto de superfícies sujas com o insert de tubo (Ampola) limpo.
4. O sistema de braçadeira dentro do Housing ou unidades independentes não deve “estressar” ou tensionar mecanicamente o tubo (Ampola).
5. Após a instalação, verifique se o tubo trabalha corretamente (sem variações da corrente do tubo nem crepitação ou ruídos anormais).
6. Cumprir com os parâmetros de inserção térmica, planejamento e de programação os parâmetros de exposição e com as pausas de resfriamento. Housings ou unidades independentes devem ser fornecidas com uma proteção térmica adequada.
7. As tensões indicadas nas tabelas são válidas para transformadores fornecidos com o centro aterrado.
8. É extremamente importante observar o diagrama de conexão e o valor do resistor da rede. Qualquer mudança pode modificar as dimensões do ponto focal, variando também os desempenhos de diagnóstico ou sobrecarregando o ânodo.
9. Os inserts (Ampolas) de tubos contém materiais poluentes ambientais, em particular tubos com revestimento de chumbo. Por favor consulte um operador qualificado para eliminação de resíduos, de acordo com os requisitos da regulamentação local.
10. Quando qualquer anormalidade for encontrada durante a operação, desligue imediatamente a fonte de alimentação e entre em contato com o engenheiro de serviço.

Notas

- Este produto de alto vácuo é produzido de acordo com tecnologia state-of-the-art. Para evitar a implosão manuseie com cuidado e utilize dispositivos de proteção, por exemplo, óculos!
- No interesse de cumprir com os requisitos legais quanto à compatibilidade ambiental dos nossos produtos (proteção dos recursos naturais, a prevenção de resíduos) nós nos esforçamos para reutilização de componentes e para devolvê-los ao ciclo de produção. Nós garantimos o funcionamento, qualidade e vida útil destes componentes tomando medidas abrangentes de garantia de qualidade, assim como

A Hangzhou Kailong Instrumentos Médicos Co., Ltd. possui certificação ISO 13485, fábrica de acordo com as Regulamentos do Sistema da Qualidade (QSR), conforme definido pela Drug Administration (FDA) e se esforça para cumprir requisitos legais relativos ao meio ambiente compatibilidade de seus produtos.

A reprodução, transmissão ou uso deste documento ou seu conteúdo não é permitido sem expressa autorização por escrito consentimento. Infratores serão responsabilizados por danos. A Kailong reserva-se o direito de modificar o design e as especificações aqui contidos sem aviso prévio. Todos os direitos reservados, particularmente em relação a pedidos de patentes ou registros do modelo ou modelo de utilidade.

© Hangzhou Kailong Medical Instruments Co.Ltda.

**Para vendas no Brasil, contate
nossa filial**

KL BRASIL

WhatsApp +55 11 94442—1708
vendas@klbrasil.com.br
www.klbrasil.com.br